

CONTRATACIÓN DIRECTA POR VÍA DE EXCEPCIÓN

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de solicitarle **prepuesto** para el día **11 DE JUNIO DE 2.021** a las **10:30 hs.**, para la adquisición de lo que se detalla a continuación.-

Rg	Cant	Artículos y Especificaciones	Marca/ Modelo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	01	AUTOANALIZADOR CLÍNICO.....		\$	\$
TOTAL \$					

CONFORME AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTO.

El Precio Unitario cotizado en cada renglón deberá presentarse con dos (2) dígitos decimales como máximo, en caso de cotizar con más dígitos, se tomarán en cuenta solamente los primeros dos, no realizándose redondeo alguno. Dicho Precio Unitario no podrá subdividirse o unificarse, en caso de existir subdivisión en algún renglón o unificación en dos o más renglones que impidan su comparación, los mismos serán descartados automáticamente sin derecho a reclamo alguno por parte del oferente.-

Monto Total Cotizado: PESOS.....

DESTINO: Hospital "Behring" de la localidad de Estación Holt, Departamento Islas del Ibicuy, Entre Ríos.-

GARANTÍA:.....

Deberá especificarse **por escrito** el plazo y alcance de la misma, el cual deberá cumplir mínimamente con el plazo establecido en **Requerimientos Generales** del Anexo de Especificaciones Técnicas.-


SERVICIO TÉCNICO:.....

Deberá indicarse nombre, domicilio y teléfono del prestador del Servicio Técnico, según lo establecido en **Requerimientos Generales** del Anexo de Especificaciones Técnicas.-

El presupuesto deberá contener las siguientes condiciones, de ser posible:

- A nombre del **Ministerio de Salud – Condición de IVA EXENTO.**-
- **Plazo de Mantenimiento de Oferta:** VEINTICINCO (25) días hábiles (mínimo).-
- **Plazo de Entrega:** Deberá especificarse en la oferta. En caso de no indicarse el mismo se tomará como INMEDIATO, entendiéndose por tal **TREINTA (30) días hábiles** desde la recepción de la correspondiente **Orden de Compra.**-
- **Lugar de Entrega:** Entregar el equipo instalado y funcionando en el Hospital "Behring", sito en calle Dr. Solsona S/Nº, Estación Holt, Departamento Islas del Ibicuy, Entre Ríos, Tel. (03446) 498 333, en presencia del Jefe del Servicio de Laboratorio y de personal propuesto por el Departamento Bioingeniería, con quien se deberá acordar la entrega con Cinco (5) días hábiles de anticipación, una vez que haya verificado que las obras de preinstalación se han realizado, e informar a División Almacenes – Departamento Contrataciones, Tel.: (0343) 420 9646/422 8382, los días hábiles, en el horario de **08:00 a 12:00 Hs.**
- **Forma y Plazo de Pago:** El pago se efectuará dentro de los **DIEZ (10) días hábiles** contados desde la aceptación definitiva de la mercadería, recepción de la documentación (Remito y Factura) y del sellado de Ley de Sellos vigente correspondiente.-
- Los presupuestos deben estar **firmados y sellados por un responsable de la Firma Comercial** en todas sus hojas y ser enviados vía e-mail a **saludcompras@hotmail.com** con el asunto "Cotización Autoanalizador Clínico – Expediente Nº 2.504.300" para su mejor identificación.-

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DPTO. CONTRATACIONES
25 de Mayo Nº 139 P. Baja (3.100) Paraná – E. Ríos
Tel.: (0343) 420-9646/422-8382
E-mail: saludcompras@hotmail.com

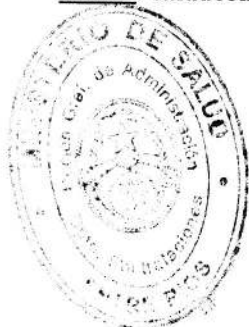

(Handwritten signature)
AGUSTÍN ESTEBAN CAROSINI
Jefe Departamento Contrataciones
Dirección General de Administración
Ministerio de Salud - E. Ríos

Firma y Sello del Oferente
o Representante Legal

C.U.I.T Nº: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

CONTRATACIÓN DIRECTA POR VÍA DE EXCEPCIÓN

Anexo de especificaciones técnicas

Autoanalizador clínico

Equipo automático fotómetro de doble haz.

- Velocidad mínima: 100 test por hora.
- Carro para por lo menos 40 reactivos.
- Carro para por lo menos 40 muestras
- Volumen de reactivo programable
- Volumen de muestra programable
- Bandeja para reactivos termostatizada
- Lavador automático de cubetas
- Calefactor por incubación de aire caliente (30° a 37 °C).
- Rango de operación entre 340 y 750 nm aproximadamente
- Sistema óptico
 - o Filtros interferenciales
 - o Lámpara halógena o Leds
 - o Ancho de banda espectral de aprox. 10 nm
- Ensayos por cinética y punto final
- Teclado protegido contra posibilidad de derrames
- Software de interfase en español
- Deberá incluir PC acorde a las necesidades del sistema, con impresora, y sistema operativo con licencia
- Alimentación 220 V, 50 Hz, con puesta a tierra.
- Lámpara de repuesto. (a excepción del sistema de iluminación a Leds)

Requerimientos generales

El oferente deberá:

- Especificar marca, modelo y adjuntar folletos ilustrativos donde puedan apreciarse claramente las características técnicas.

- Adjuntar descripción técnica completa en castellano.
- Indicar las condiciones de preinstalación
- Adjuntar registro ANMAT del equipo
- Garantizar: mínimo 12 meses contra todo defecto de fabricación y-o funcionamiento a partir de la recepción definitiva del equipo.
- Adjuntar por lo menos índice de manual de uso y el índice del manual técnico en castellano. En caso de considerarse necesario se le solicitará el manual correspondiente para una correcta evaluación técnica.
- Garantizar la provisión de repuestos críticos durante un período mínimo de 5 años.
- Garantizar la actualización del software del equipo por un período mínimo de 5 años, sin cargo.
- Especificar con nombre, domicilio y teléfono el servicio técnico calificado (Ingeniero, Bioingeniero y/o Técnico especializado) en la zona que garantice su respuesta en un plazo inferior a 48 hs. El servicio técnico deberá acreditar una experiencia mínima de 2 años en mantenimiento de equipos similares.
- Presentar un plan detallado de capacitación a usuario.
- Presentar un plan de capacitación técnica en mantenimiento para 2 personas propuestas desde el Departamento Bioingeniería del Ministerio de Salud. El plan deberá incluir un detalle del temario y duración.


El adjudicatario deberá:

- Una vez recibida la orden de compra, brindar asesoramiento para la ejecución de las obras de preinstalación.
- Entregar el equipo instalado y funcionando, en presencia del jefe del servicio Laboratorio y de personal propuesto por el

CONTRATACIÓN DIRECTA POR VÍA DE EXCEPCIÓN

Departamento Bioingeniería, con quién se deberá acordar la entrega con 5 días hábiles de anticipación, una vez que haya verificado que las obras de presinstalación se han realizado.

- Realizar la capacitación a usuario al momento de la instalación del equipo, a todos los integrantes del servicio. Una vez finalizada se labrará un acta de conformidad del Jefe del Servicio Laboratorio y del Director del hospital.
- Concretar la capacitación técnica, labrar un acta de conformidad.
- Entregar 2 juegos de manual de uso y manual técnico completo, en castellano, durante el proceso de capacitación técnica.
- Responder en un plazo máximo de 48 hs, durante la vigencia de la garantía, los pedidos de reparación y-o revisión que se soliciten a través del Departamento Bioingeniería del Ministerio de Salud



MÓNICA B. BAROLI
Bioingeniera Mat. 41085 (Clear)
Jefe Div. Ingeniería Clínica
Departamento Bioingeniería
Ministerio de Salud de E. E.



JORGE R. BELLMANN
Bioingeniero Mat. 40895 (Clear)
Jefe Departamento Bioingeniería
Ministerio de Salud de E. E.